

Labordiagnosztikai részlelet

(A részlelet nem tartalmazza az összes kért vizsgálat eredményét!)

Lelet azonosító: R_95746523
Beküldött vonalkód: 20306849
Beküldő: Suttogo Állatorvosi Rendelő
Beküldő állatorvos: 5227 - Dr. Zacharewicz Barbara
Minta fogadás: 2022-09-16 14:15:39
Beküldött minták: EDTÁ-s teljes vér (203068492), szérum (203068493)
Állat neve: Panni
Tulajdonos: Simon Katalin
Faj: Eb/kutya
Fajta: Boston terrier
Ivar: Nőstény
Szül. idő: 2019-05-27

Az állat PraxisLab azonosítója*: 338875

Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!


2019.03.01-től a vérképek vizsgálatának rendszere megváltozott.

Bővebb információ (áo belépés után):

<http://praxislab.hu/lab/page/inside-page/praxislab-2019-es-valtozasok>

Panel:

Rutin vérképpel (kutya)
Szimmetrikus dimetil-arginin (SDMA)
Lipaemia
Ikterusz
Hemolízis

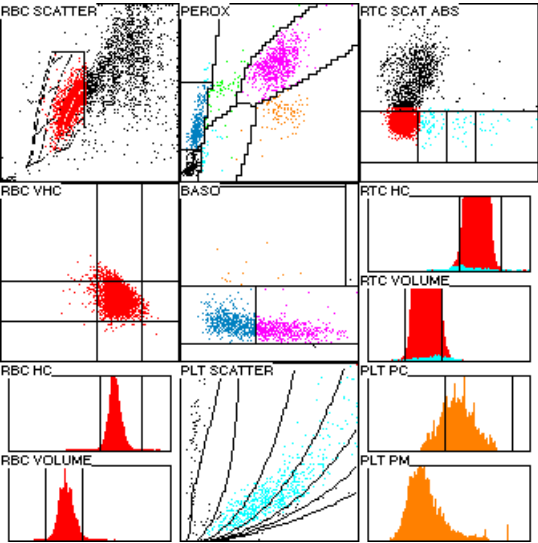

Vizsgálat	Eredmény	Mértékegység	Referencia
AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 2120			
Vörösvérsejtszám	7.98	T/L	5,50 - 8,50
Hemoglobin	+ 182	g/L	120 - 180
Hematokrit	56.7	%	38.0 - 57.0
MCV (átl. vvs térf)	71	fL	61 - 80
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)	22.8	pg	20.0 - 26.0
MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)	322	g/L	300 - 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.	328.00		300-360
Mért vvs Hb tartalom	23.20		

Vvs méret szórás	12.7	12.0 - 13.2
Hb koncentráció eloszlási szélesség	19.50	
Vvs Hb szórás	2.96	
Hypochrom vvs %	1	%
Macrocytaer vvs%	2	%
Thrombocyta	338	G/L150 - 450
Átlagos vérelemeske térfogat	—8.3	fL8.5 - 14.5
Mean Platelet Component	22	g/L
Thrombokrit	0.28	%0.18—0.44
Thrombocyta térfogat szórás	43	
Makrothrombocyta	+	
Fehérvérsejtszám	8.0	G/L6.0 - 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)	—3.9	G/L4.3 - 9.0
Lymphocyta abs. (Advia 120)	3.30	G/L0.50 - 4.50
Monocyta abs. (Advia 120)	0.30	G/L0.25 - 1.00
Eosinophil abs. (Advia 120)	0.40	G/L0.10 - 1.20
Basophil abs. (Advia 120)	0.00	G/L0.01 - 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)	0.00	G/L0.03 - 0.58
RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 2120		
Abszolút retikulocitaszám	50.4	G/L<60 G/L
Anaemia esetén a reticulocyta-válasz elbírálása az alábbiak szerint alakul:< 60 G/l Nincs regenerációkb. 150 G/l Enyhe regenerációkb. 300 G/l Közepes regeneráció> 500 G/l Kifejezett regenerációCharles W Brockus in Kenneth S Latimer Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011, Wiley-Blackwell		
Retikulocyta %	0.6	%
Reticulocyta MCV	—80.40	fL81.00 - 97.00
Reticulocyta cellularis Hb	23.80	pg
Retikulocyta Hb koncentráció	+303.00	262.00 - 281.0
Reticulocyta RDW	21.10	
Alacsony festődésű reticulocyták	236.0	68.0 - 647.0
Alacsony festődésű reticulocyta %	—58.6	65.0 - 91.0
Közepes festődésű reticulocyták	117.00	6.40 - 260.0
Közepes festődésű reticulocyta %	29.00	
Magas festődésű reticulocyták	50	
Magas festődésű reticulocyta %	+12	4.30 - 10.00
MCV delta	10.55	
CHDW delta	0.72	
HDW delta	33.60	
RDW delta	9.10	

KLINIKAI KÉMIA - ENZIMEK/SZUBSZTRÁTOK			
Összfehérje	63	g/L	55 - 75
Albumin	33.1	g/L	25.0 - 41.0
Globulin	29.9	g/L	20.0 - 45.0
A/G arány	1.11		0.60 - 1.50
ALT (GPT)	+ 65	U/L	5 - 60
AST (GOT)	34	U/L	10 - 50
GLDH	4	U/L	- 10
Alkalikus foszfatáz	54	U/L	- 280
EDTA kontamináció esetén ALKP aktivitás fals alacsony lehet.			
GGT	4	U/L	- 9
Összbilirubin	3.5	umol/L	0.1 - 5.1
Alfa amiláz	508	U/L	100 - 1200
Lipáz (pancreas)	15	U/L	8-81
CK (kreatin-kináz)	68	U/L	20 - 225
LDH	29	U/L	20 - 250
Triglicerid	0.35	mmol/L	0.30 - 1.20
Koleszterin	4.5	mmol/L	3.2 - 6.2
Glükóz (Szérum)	+ 5.7	mmol/L	2.8 - 4.9
Nem NaF-os csőből mért érték. A szérumot több mint 30 perccel a vérvétel után elkülönítve, a valós koncentráció magasabb lehet.			
Fruktózamin	272	umol/L	187 - 386
Karbamid	6.5	mmol/L	2.5 - 6.7
Kreatinin	90	umol/L	20 - 150
KLINIKAI KÉMIA - ELEKTROLITOK			
Nátrium	148	mmol/L	135 - 155
Kálium	++ 6.37	mmol/L	3.60 - 5.60
EDTA kontaminációra utaló érték.			
Na/K arány	-- 23.23		28.80 - 40.00
Klorid	111	mmol/L	100 - 116
Kalcium	-- 1.95	mmol/L	2.50 - 3.10
EDTA kontaminációra utaló érték.			
Magnézium	-- 0.56	mmol/L	0.70 - 1.00
EDTA kontaminációra utaló érték.			
Foszfát	1.0	mmol/L	0.8 - 1.6
KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK			
Vas	--- 2.0	umol/L	18.0 - 25.0
EDTA kontaminációra utaló érték.			
Látens vaskötő kapacitás	44.0		

Teljes vaskötő kapacitás	–	46.00	umol/L	50.00 - 100.0
C-reaktív protein	Detektálási határ alatt			
Szimmetrikus dimetil-arginin (SDMA.)	folyamatban...			
MINTA MINŐSÉGI INDEXEK				
Hemolizis	NORMAL			
Ikterusz	NORMAL			
Lipaemia	NORMAL			