

Labordiagnosztikai lelet


Lelet azonosító: R_95746523
Beküldött vonalkód: 20306849
Beküldő: Suttogo Állatorvosi Rendelő
Beküldő állatorvos: 5227 - Dr. Zacharewicz Barbara
Minta fogadás: 2022-09-16 14:15:39
Beküldött minták: EDTÁ-s teljes vér (203068492), szérum (203068493)
Állat neve: Panni
Tulajdonos: Simon Katalin
Faj: Eb/kutya
Fajta: Boston terrier
Ivar: Nőstény
Szül. idő: 2019-05-27

Az állat PraxisLab azonosítója*: 338875
Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!

2019.03.01-től a vérképek vizsgálatának rendszere megváltozott.
Bővebb információ (áo belépés után):
<https://praxislab.hu/lab/page/inside-page/praxislab-2019-es-valtozasok>

Panel:

Rutin vérképpel (kutya)
Szimmetrikus dimetil-arginin (SDMA)
Lipaemia
Ikterusz
Hemolízis

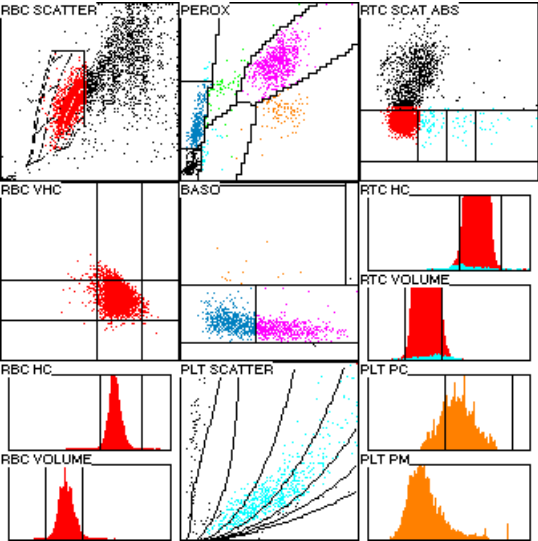

Vizsgálat	Eredmény		Mértékegység	Referencia
AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 2120				
Vörösvérsejtszám	7.98		T/L	5,50 - 8,50
Hemoglobin	+	182	g/L	120 - 180
Hematokrit	56.7		%	38.0 - 57.0
MCV (átl. vvs térf)	71		fL	61 - 80
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)	22.8		pg	20.0 - 26.0
MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)	322		g/L	300 - 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.	328.00			300-360
Mért vvs Hb tartalom	23.20			
Vvs méret szórás	12.7			12.0 - 13.2

Hb koncentráció eloszlási szélesség		19.50		
Vvs Hb szórás		2.96		
Hypochrom vvs %		1	%	
Macrocytaer vvs%		2	%	
Thrombocyta		338	G/L	150 - 450
Átlagos vérelemeske térfogat	—	8.3	fL	8.5 - 14.5
Mean Platelet Component		22	g/L	
Thrombokrit		0.28	%	0.18–0.44
Thrombocyta térfogat szórás		43		
Makrothrombocyta		+		
Fehérvérsejtszám		8.0	G/L	6.0 - 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)	—	3.9	G/L	4.3 - 9.0
Lymphocyta abs. (Advia 120)		3.30	G/L	0.50 - 4.50
Monocyta abs. (Advia 120)		0.30	G/L	0.25 - 1.00
Eosinophil abs. (Advia 120)		0.40	G/L	0.10 - 1.20
Basophil abs. (Advia 120)		0.00	G/L	0.01 - 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)		0.00	G/L	0.03 - 0.58
RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 2120				
Abszolút retikulocitaszám		50.4	G/L	<60 G/L
Anaemia esetén a retikulocyta-válasz elbírálása az alábbiak szerint alakul:< 60 G/l Nincs regenerációkb. 150 G/l Enyhe regenerációkb. 300 G/l Közepes regeneráció> 500 G/l Kifejezett regenerációCharles W Brockus in Kenneth S Latimer Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011, Wiley-Blackwell				
Retikulocyta %		0.6	%	
Reticulocyta MCV	—	80.40	fL	81.00 - 97.00
Reticulocyta cellularis Hb		23.80	pg	
Retikulocyta Hb koncentráció	+	303.00		262.00 - 281.0
Reticulocyta RDW		21.10		
Alacsony festődésű reticulocyták		236.0		68.0 - 647.0
Alacsony festődésű reticulocyta %	—	58.6		65.0 - 91.0
Közepes festődésű reticulocyták		117.00		6.40 - 260.0
Közepes festődésű reticulocyta %		29.00		
Magas festődéső reticulocyták		50		
Magas festődésű reticulocyta %	+	12		4.30 - 10.00
MCV delta		10.55		
CHDW delta		0.72		
HDW delta		33.60		
RDW delta		9.10		
KLINIKAI KÉMIA - ENZIMEK/SZUBSZTRÁTOK				

Összfehérje		63	g/L	55 - 75
Albumin		33.1	g/L	25.0 - 41.0
Globulin		29.9	g/L	20.0 - 45.0
A/G arány		1.11		0.60 - 1.50
ALT (GPT)	+	65	U/L	5 - 60
AST (GOT)		34	U/L	10 - 50
GLDH		4	U/L	- 10
Alkalikus foszfatáz		54	U/L	- 280
EDTA kontamináció esetén ALKP aktivitás fals alacsony lehet.				
GGT		4	U/L	- 9
Összbilirubin		3.5	umol/L	0.1 - 5.1
Alfa amiláz		508	U/L	100 - 1200
Lipáz (pancreas)		15	U/L	8-81
CK (kreatin-kináz)		68	U/L	20 - 225
LDH		29	U/L	20 - 250
Triglicerid		0.35	mmol/L	0.30 - 1.20
Koleszterin		4.5	mmol/L	3.2 - 6.2
Glükóz (Szérum)	+	5.7	mmol/L	2.8 - 4.9
Nem NaF-os csőből mért érték. A szérumot több mint 30 perccel a vérvétel után elkülönítve, a valós koncentráció magasabb lehet.				
Fruktózamin		272	umol/L	187 - 386
Karbamid		6.5	mmol/L	2.5 - 6.7
Kreatinin		90	umol/L	20 - 150
KLINIKAI KÉMIA - ELEKTROLITOK				
Nátrium		148	mmol/L	135 - 155
Kálium	++	6.37	mmol/L	3.60 - 5.60
EDTA kontaminációra utaló érték.				
Na/K arány	--	23.23		28.80 - 40.00
Klorid		111	mmol/L	100 - 116
Kalcium	--	1.95	mmol/L	2.50 - 3.10
EDTA kontaminációra utaló érték.				
Magnézium	--	0.56	mmol/L	0.70 - 1.00
EDTA kontaminációra utaló érték.				
Foszfát		1.0	mmol/L	0.8 - 1.6
KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK				
Vas	---	2.0	umol/L	18.0 - 25.0
EDTA kontaminációra utaló érték.				
Látens vaskötő kapacitás		44.0		
Teljes vaskötő kapacitás	-	46.00	umol/L	50.00 - 100.0

C-reaktív protein	Detektálási határ alatt		
Szimmetrikus dimetil-arginin (SDMA.)	7.3	ug/dL	0-14
Előzetes, irodalmi (iris-kidney.com) referencia értéket és döntési limiteket használunk.			
MINTA MINŐSÉGI INDEXEK			
Hemolizis	NORMAL		
Ikterusz	NORMAL		
Lipaemia	NORMAL		

Validálta: Dr. Csöndes Judit

Leleteink online elérhetők a www.praxislab.hu oldalon a beutalók menüpontban.

Leletkiadás: 2022-09-20 16:02